

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá lập giá kế hoạch mua sắm lần 1 cho dự toán mua sắm “Mua sắm hàng hóa – Cung cấp và lắp đặt linh kiện, phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – Lần 1 – 2025” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi đồng 1.
- Thông tin cơ bản yêu cầu báo giá tra cứu theo mã YCBG như sau:
 - Website đăng YCBG: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>
 - Mã YCBG: RQ2500002248
- Các hiệu lực Yêu cầu báo giá:
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng YCBG lên hệ thống.
 - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 8 tháng.
 - Thời gian giao hàng dự kiến: 6 tháng, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo quy định của Luật Thương mại.
- Hình thức và phương thức tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ chào giá bản giấy (có đóng dấu và ký tên) tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Tiếp nhận hồ sơ điện tử (file word/excel + File PDF) scan từ bản giấy (có đóng dấu và ký tên):
 - Cấu trúc tên email (subject email): LKPK 2025 – Mua sắm hàng hóa – Cung cấp và lắp đặt linh kiện, phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – Lần 1 – 2025 – [Tên nhà cung cấp]
 - Địa chỉ email tiếp nhận báo giá: p.vtttb@nhidong.org.vn và vttbyt.bvnd1@gmail.com

[Scan vị trí nộp hồ sơ]



5. Các thông tin khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá/ bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) và các tài liệu khác theo yêu cầu của **Biểu mẫu chào giá**.
- Bảng kê danh mục hàng hóa, bảng tính năng kỹ thuật chi tiết trang thiết bị y tế theo Thư chào giá – **Biểu mẫu và hướng dẫn** (chi tiết theo **Bảng kê chi tiết thông tin hàng hóa**).
- Các tài liệu căn cứ xác định giá tương tự của hàng hóa: quyết định trúng thầu/hợp đồng tương tự của loại hàng hóa/dịch vụ tương tự (tương đồng gần nhất với yêu cầu chào giá của loại hàng hóa/dịch vụ mà công ty/nhà thầu tham gia chào giá).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT,TBYT (NTH,1b).



PHẠM ĐÌNH NGUYỄN

Yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Đồng 1 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm hàng hóa – Cung cấp và lắp đặt linh kiện, phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 – Lần 1 – 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 1

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 1
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Dương Phan Trung Tâm
 - Chức vụ: Tổ trưởng
 - Số điện thoại: 0919923377
 - Địa chỉ: Phòng Vật Tư, Thiết Bị Y Tế -Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Tp. HCM
 - Email: p.vttb@nhi dong.org.vn
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, Email
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ ngày đến ngày 22/03/2025 15:00
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 22/03/2025 15:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Bo mạch điều khiển phần tĩnh gantry hệ thống CT Scanner	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
2	Gioăng cửa máy hấp tiệt trùng EO	4	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
3	Bo nguồn máy hấp tiệt trùng EO	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
4	Cảm biến chốt cửa máy hấp tiệt trùng EO	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
5	Bóng đèn Xenon nguồn sáng nội soi	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
6	Bo mạch điều khiển trung tâm máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
7	Ố cứng máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		
8	Bóng X-Quang	1	Cái	Yêu cầu dịch vụ chi tiết đính kèm	Bệnh viện Nhi Đồng 1		

Yêu cầu dịch vụ


Yêu cầu thông số kỹ thuật của linh phụ kiện là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu.

STT	Tên hàng hóa	Loại máy	Model máy	SL mua	ĐVT	Yêu cầu dịch vụ	Yêu cầu đầu ra	Khoa sử dụng
1	Bộ mạch điều khiển phần tĩnh gantry (khoảng máy) hệ thống CT Scanner	Hệ thống CT Scanner hãng Siemens	Somatom Scope	1	Cái	Tương thích với hệ thống CT Scanner hãng Siemens, model Somatom Scope đang sử dụng tại bệnh viện. - Điện áp đầu vào: 24 VDC / 5 VDC. - Chuẩn giao tiếp: CAN/Fast link/Lan.	Miễn phí lắp đặt bộ mạch điều khiển phần tĩnh gantry (khoảng máy) tương thích hệ thống CT Scanner hãng Siemens, model Somatom Scope đang sử dụng tại bệnh viện. Sau khi thay thế hệ thống CT Scanner Siemens hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành bộ mạch điều khiển phần tĩnh gantry (khoảng máy) ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	XQ
2	Gioăng cửa máy hấp tiết trùng EO	Máy hấp tiết trùng EO hãng 3M	GS8-2D	4	Cái	Tương thích với máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện.	Miễn phí lắp đặt gioăng của máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện. Sau khi thay thế máy hấp hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành vật tư thay thế ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	KSNK
3	Bộ nguồn máy hấp tiết trùng EO	Máy hấp tiết trùng EO hãng 3M	GS8-2D	1	Cái	Tương thích với máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện. Công suất 300 W, đầu ra nguồn đôi 5V/12.5 A và 12V/10A.	Miễn phí lắp đặt bộ nguồn máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện. Sau khi thay thế máy hấp hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	KSNK
4	Cảm biến chốt cửa máy hấp tiết trùng EO	Máy hấp tiết trùng EO hãng 3M	GS8-2D	1	Cái	Tương thích với máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện.	Miễn phí lắp đặt cảm biến chốt cửa tương thích máy hấp tiết trùng EO hãng 3M, model GS8-2D đang sử dụng tại bệnh viện. Sau khi thay thế máy hấp hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	KSNK
5	Bóng đèn Xenon nguồn sáng nội soi	Nguồn sáng nội soi Olympus	CLV-180	1	Cái	Tương thích với nguồn sáng nội soi Olympus model CLV-180 đang sử dụng tại bệnh viện. Công suất 300 W, Tuổi thọ 1000 giờ.	Miễn phí lắp đặt bóng đèn Xenon tương thích nguồn sáng nội soi Olympus, model CLV-180 đang sử dụng tại bệnh viện. Sau khi thay thế nguồn sáng hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	Tiêu hóa

BỘ Y TẾ
TRUNG ƯƠNG

6	Bo mạch điều khiển trung tâm máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	Máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	Tesla M3	1	Cải	Tương thích với máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI, model Tesla M3 đang sử dụng tại bệnh viện.	Miễn phí lắp đặt bo mạch điều khiển trung tâm tương thích máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI, model Tesla M3. Sau khi thay thế thiết bị hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	XQ
7	Ổ cứng máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	Máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI	Tesla M3	1	Cải	Tương thích với máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI, model Tesla M3 đang sử dụng tại bệnh viện.	Miễn phí lắp đặt ổ cứng tương thích máy monitor dùng trong phòng chụp cộng hưởng từ MRI, model Tesla M3. Sau khi thay thế thiết bị hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 06 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.	XQ
8	Bóng X-Quang	Máy chụp X-Quang cố định Shimadzu	RADspeed MF	1	Cải	1. Điện áp danh định của bóng: - Khi chiếu: $\geq 125 \text{ kV}$. - Khi chụp: $\geq 150 \text{ kV}$. 2. Vô bóng phát tia X: - Khả năng trữ nhiệt lớn nhất: $\geq 1100 \text{ kJ}$ (1600 KHU). - Công suất tản nhiệt liên tục lớn nhất: + Khi có quạt: $\geq 470 \text{ W}$ (660 HU/S). + Khi không có quạt: $\geq 235 \text{ W}$ (330 HU/s). 3. Bóng phát tia X: - Khả năng trữ nhiệt lớn nhất của Anode: $\geq 140 \text{ kJ}$ (200 KHU). - Công suất tản nhiệt lớn nhất của Anode: $\geq 640 \text{ W}$ (900 HU/S). - Công suất tản nhiệt liên tục lớn nhất: $\geq 210 \text{ W}$ (300HU/S). 4. Tiêu điểm bóng X-Quang: Tối thiểu có 02 tiêu điểm $\leq 0,6 \text{ mm}$ và $\leq 1,2 \text{ mm}$. - Tiêu điểm nhỏ: $\leq 0,6$. + Nguồn công suất đầu vào Anode (0.1s) tần số: 50 Hz: Công suất: $\leq 18 \text{ kW}$. - Điện áp đốt tóc tối đa: $\leq 12,5 \text{ V}$. + Điện áp đốt tóc tối đa: $\geq 5,6 \text{ A}$. - Dòng đốt tóc tối đa: $\geq 5,6 \text{ A}$. - Tiêu điểm lớn: $\leq 1,2$. + Nguồn công suất đầu vào Anode (0.1s) tần số: 50 Hz: Công suất: $\leq 48 \text{ kW}$. + Điện áp đốt tóc tối đa: $\leq 18,4 \text{ V}$. + Dòng đốt tóc tối đa: $\geq 5,6 \text{ A}$. 5. Góc nghiêng Anode: ≥ 12 độ, đường kính $> 100 \text{ mm}$, tốc độ quay ≥ 2700 vòng/phút ở 50 Hz. 6. Bộ lọc tối thiểu tương đương $\geq 1,5 \text{ mm Al}$. 7. Trường phát xạ tia X: ($\geq 350 \text{ mm}$) $\times$ ($\geq 350 \text{ mm}$) (Tại khoảng cách 1000 mm tính từ tâm bóng). 8. Trọng lượng bóng: $21 \text{ kg} \pm 5\%$.	Miễn phí lắp đặt Bóng X-Quang Tương thích máy chụp X-Quang cố định Shimadzu, model RADspeed MF. Sau khi thay thế thiết bị hoạt động ổn định, an toàn theo tiêu chuẩn hãng sản xuất thiết bị. Bảo hành linh kiện thay thế ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng. Kiểm định tại thiết bị sau khi thay thế bóng X-Quang theo QCVN 11:2015/BKHCN.	XQ

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CHÀO GIÁ

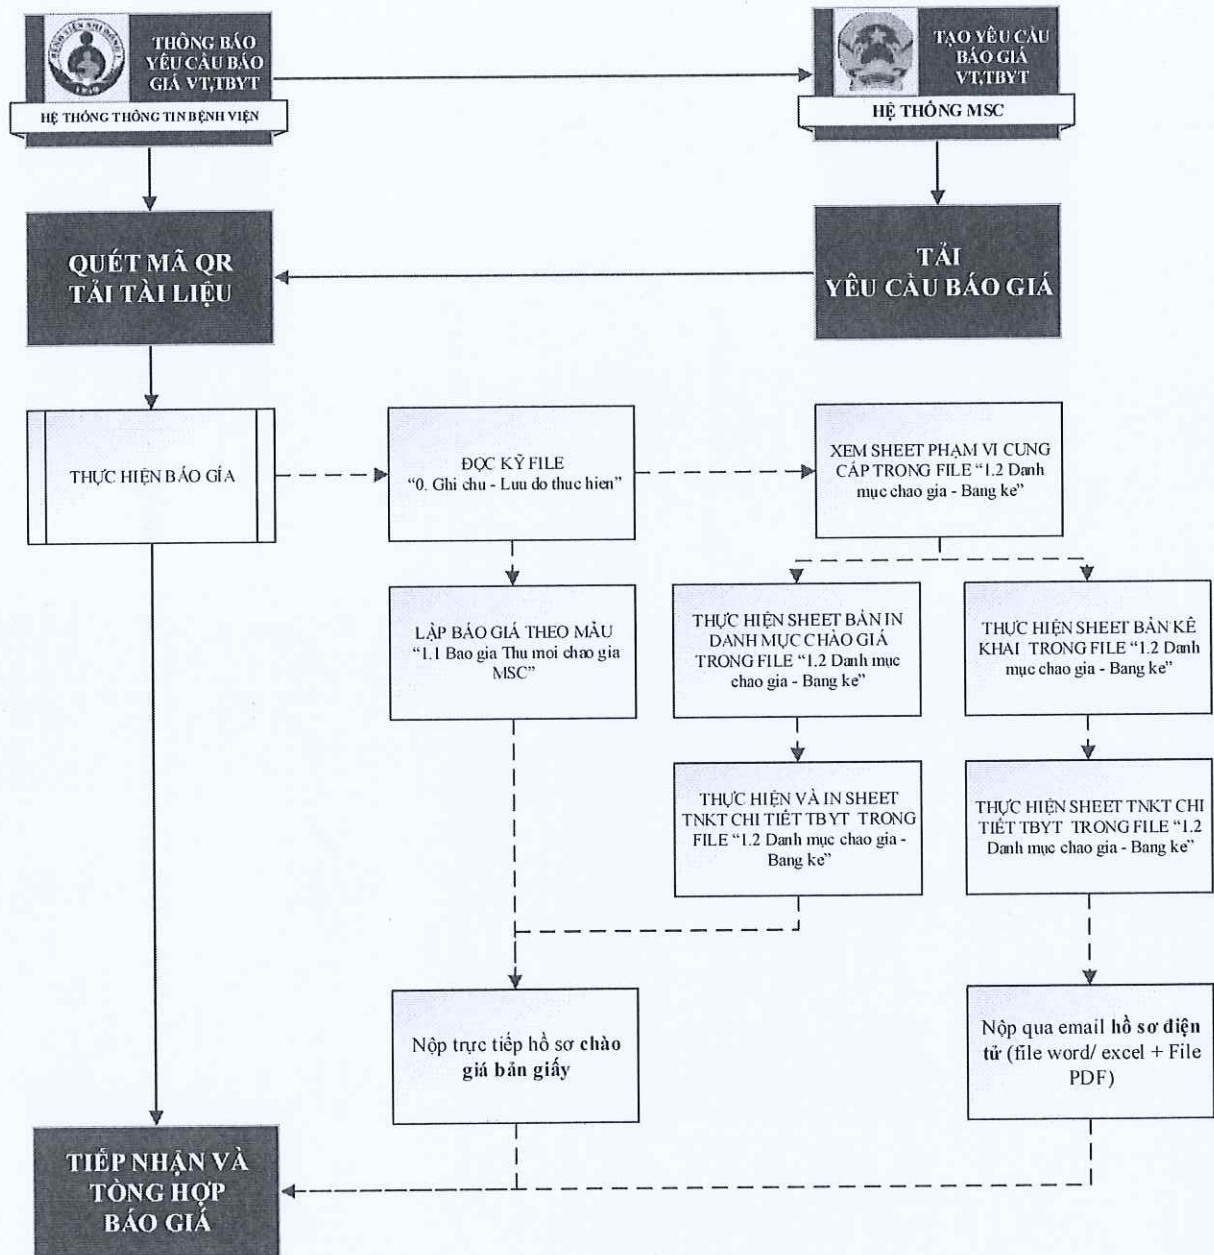

1/ CẤU TRÚC EMAIL ĐÚNG THEO YCBG.

2/ BÁO GIÁ VÀ BẢNG KÊ SỬ DỤNG ĐÚNG MẪU ĐÍNH KÈM YCBG, KHÔNG ĐIỀU CHỈNH MẪU, THÊM CỘT.

3/ GỬI KÈM TÀI LIỆU KỸ THUẬT, ĐÁNH DẤU THÔNG TIN LIÊN QUAN TNKT ĐÃ KÊ KHAI TRONG BẢNG KÊ.

4/ KHI NỘP BÁO GIÁ KÈM THEO CHECK LIST HỒ SƠ CHÀO GIÁ.

5/ TẤT CẢ HỒ SƠ NỘP QUA EMAIL THỐNG NHẤT VỚI HỒ SƠ NỘP BẢN CHÍNH VÀO BỆNH VIỆN TRỪ BẢNG KÊ.

PHỤ LỤC: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Tên công ty:

Địa chỉ theo GPĐKKD:

MST - SĐT – FAX:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá [Dự toán mua sắm/ gói thầu: ...] của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Đính kèm Biểu mẫu danh mục chào giá hàng hóa

2. Thông tin liên hệ của Bên chào giá

Tên công ty: [tên theo GP ĐKKD]

Người lập bảng:

Thông tin liên lạc: [SĐT] - [Email]

3. Chúng tôi cam kết:

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ thuế giá trị gia tăng (GTGT), các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định pháp luật; chi phí vận chuyển, bốc dỡ, và các chi phí liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt; chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành; chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: [...] ngày, kể từ ngày hết hạn YCBG trên hệ thống.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp^(*)**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



PHỤ LỤC: BIỂU MẪU DANH MỤC BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Đính kèm Báo giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng 1)

Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp																	
STT	Mã kiểm soát/ mã kho	Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT	Tên theo TT04	Mã GMDN	Tên loại theo GMDN	Tên thương mại	Tính năng kỹ thuật chi tiết hàng hóa	Mã HS	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Hãng / Nước chủ sở hữu	Hãng / Nước sản xuất	Đơn vị tính nhỏ nhất của hàng hóa (có giá trị quy đổi)	Quy cách đóng gói (có giá trị quy đổi)	Đơn vị tính hàng hóa mỗi thầu	Số lượng dự toán theo Đơn vị tính mỗi thầu	Đơn giá	Thành tiền
							Đổi với TBYT: đính kèm bảng phụ lục tình năng Chi tiết hàng hóa					"có thể trình với Đơn vị tính nếu không chia nhỏ số lượng sử dụng"					

Đính kèm theo các tài liệu chứng minh về [phương pháp luận tính năng/thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, xuất xứ] và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm
Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

PHỤ LỤC: DANH SÁCH TÀI LIỆU BÁO GIÁ

(Đính kèm Báo giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng 1)

STT	TÊN HỒ SƠ	BẢNG GIẤY	BẢNG ĐIỆN TỬ	KIỂM TRA (Khi nộp hồ sơ)	
				CHECK	NGƯỜI NỘP
1	BẢNG BÁO GIÁ.				
2	DANH MỤC CHÀO GIÁ THEO MẪU YCBG.				
3	BẢNG YÊU CẦU DỊCH VỤ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.				
4	CÁC CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ TƯƠNG TỰ CỦA HÀNG HÓA.				
	Quyết định và hợp đồng trúng thầu rộng rãi				
	Kê khai giá				
...	...	...	...	...	...
5	CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH THÔNG TIN TẠI MỤC (2) VÀ MỤC (3) VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC				
	Tài liệu xuất xứ: CO/ CQ/ MDR ...				
	Tài liệu chất lượng: ISO, FDA ...				
	Tài liệu kỹ thuật: user manual, service manual, Spectification ...				
	Tài liệu phân loại và lưu hành hợp lệ của hàng hóa ...				
...	...	...	...	...	...



✓

Ghi chú:

(*) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú (1).

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Thông tin hàng hóa YCBG” trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Thông tin hàng hóa Chào giá - Nhà cung cấp”.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mã nhóm theo TT04/2017/TT-BYT, GMDN, HS ... (nếu có) của từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (đã bao gồm thuế và chi phí liên quan) tương ứng với từng hàng hóa, hóa chất.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho đơn giá và thành tiền theo số lượng phù hợp với Đơn vị tính hàng hóa mời thầu. Giá trị ghi tại hai cột “Đơn giá” và “Thành tiền” này được hiểu là toàn bộ chi phí của hàng hóa, hóa chất (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Phạm vi cung cấp - Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá đã bao gồm chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá và các tài liệu liên quan. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá cùng các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống triển khai).